Bravo Guide de référence rapide

1 800 667-7733
1 800 572-1211
+49 (0) 7561 98343-0
+1 416 446-4500

Il faut consulter le manuel de l'opérateur avant d'utiliser cet autoclave

FONCTIONNEMENT

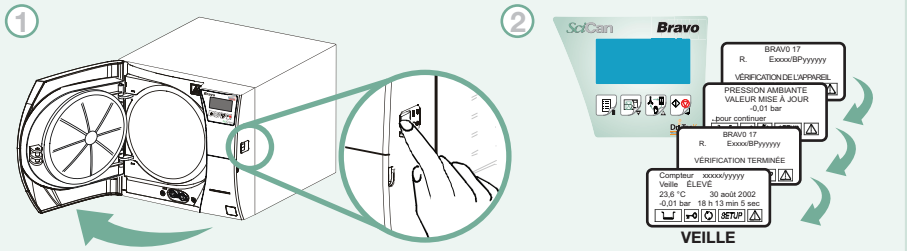

3 Remplir – Eau distillée à la vapeur uniquement (au besoin)

Manuel — E030

Automatique — A040

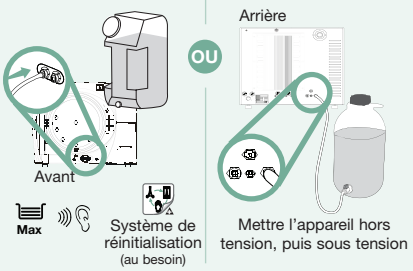

4

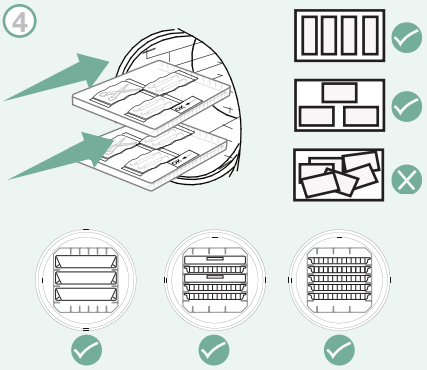

5

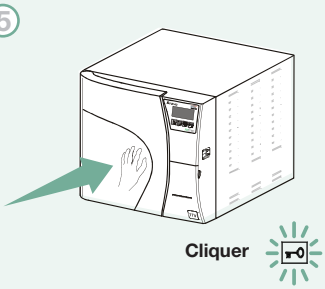

6

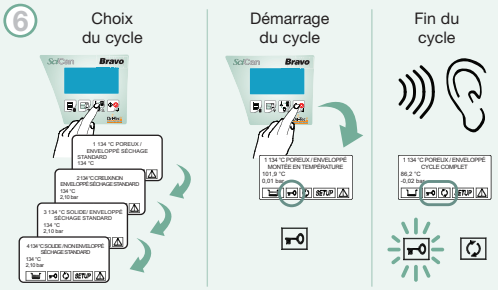
Choix du cycle
Démarrage du cycle
Fin du cycle
SciCan Bravo
1 134 °C POREUX / ENVELOPPÉ SÉCHAGE STANDARD 134 °C 2.10 bar
2 134°C CORELAVON ENVELOPPÉ SÉCHAGE STANDARD 134 °C 2.10 bar
3 134 °C SOLIDE/ ENVELOPPÉ SÉCHAGE STANDARD 134 °C 2.10 bar
4 134°C SOLIDE, NON ENVELOPPÉ SÉCHAGE STANDARD 134 °C 2.10 bar
SETUP
1 134 °C POREUX / ENVELOPPÉ MONTÉE EN TEMPÉRATURE
1 134 °C POREUX / ENVELOPPÉ CYCLE COMPLET

7 8

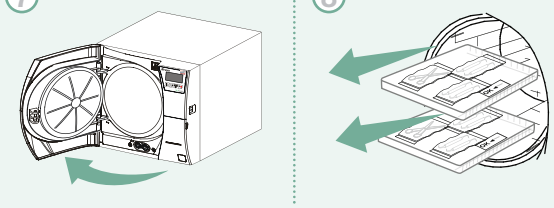

7 Drain manuel (au besoin)



PAVÉ



Réinitialiser Tenir enfoncé pendant 3 sec.

Interrompre Tenir enfoncé pendant 3 sec.

DESCRIPTION DU CYCLE

Poreux ou creux
– textiles, instruments creux, munis de flux lumineux ou solides *(c'est-à-dire: blouses de laboratoire, pièces à main, endoscopes, Phaco)*

Solides
– Instruments solides, non munis de flux lumineux *(c'est-à-dire: ciseaux, miroirs, pinces, instruments à détartrer, fraise rotative)*

Enveloppés :
– Instruments qui sont enveloppés dans un linge ou un emballage de papier ou ensaché dans un sachet entièrement en papier ou en papier et en plastique. Également utilisés lorsque des charges mélangées sont traitées.

Non enveloppés :
– Instruments qui sont introduits sans emballage d'aucune sorte.

VENTILATION

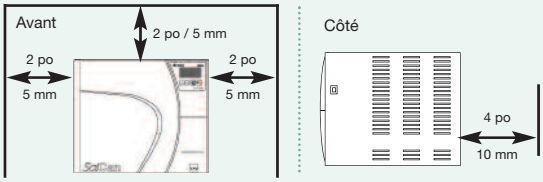

REMPLISSAGE – Eau distillée à la vapeur uniquement

Remplissage manuel (au besoin)



Remplissage automatique



ÉVACUATION

Drain manuel (au besoin)



Drain automatique



PROGRAMME D'ENTRETIEN

Pour assurer un bon fonctionnement sans incident, les opérateurs doivent suivre ce programme d'entretien.

TOUS LES JOURS

Joint d'étanchéité	• Il est recommandé de vérifier l'usure du joint d'étanchéité et de le remplacer au besoin. • Nettoyez le joint d'étanchéité à l'aide d'un linge doux.
Réservoir d'eau usée	• Videz complètement le réservoir d'eau usée chaque fois que vous remplissez le réservoir d'eau distillée
Enregistreur de données	• Si vous utilisez un enregistreur de données USB, transférer les données sur votre ordinateur
Filtre du drain de la chambre	• Inspectez, nettoyez ou remplacez le filtre du drain

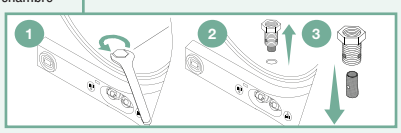

TOUTES LES SEMAINES

Chambre de stérilisation	• Nettoyez la chambre et les accessoires appropriés à l'aide d'un linge humide. Au besoin, utilisez un détergent neutre (un détergent doux ne contenant aucun alcali ni javellisant). Rincez avec soin à l'eau distillée et éliminez tout résidu. • Nettoyez le filtre du drain de la chambre

TOUS LES MOIS

Soupape de sûreté	• Testez la soupape de sûreté située à l'arrière de l'appareil.

TOUS LES 3 À 6 MOIS

Filtre biologique	• Inspectez et remplacez le filtre, au besoin.

TOUS LES ANS

Joint d'étanchéité	• Remplacez à chaque 1 000 cycles ou 12 mois (selon ce qui survient en premier).

GÉNÉRALITÉS

Tension	• Avant l'installation assurez-vous que le tension d'entrée se situe entre 215-245 volts
Papier pour imprimante	• Si le papier pour l'imprimante ne permet pas de bien imprimer, retirez-le, resserrez-le autour du rouleau et essayez de nouveau.

PIÈCES / ACCESSOIRES

• Joint d'étanchéité	48000050000
• Filtre biologique	47200010000
• Filtre du drain de la chambre	47200030000
• Papier thermique	STXX0250000
• Support de chambre 17/1 7V	C1 BP583000Y
• Support de chambre 21V	C1 BG534000Y
• Plateau, 17/17V	C1XP076000Y
• Plateau, 21V	C1BG345000Y
• Poignée pour plateau	STXX0080000
• Support pour sachets	C1BP553000Y
• Pot à eau	A0XP001 0000
• Trousse de prise d'eau de tirage	01-111774S
• Trousse direct au drain	01-111 775S
• Enregistreur de données (G)	01-111729
• Enregistreur de données (T)	01-111730

Pratiques exemplaires : SciCan recommande à l'utilisateur final de choisir méticuleusement le cycle de stérilisation le plus approprié conformément aux recommandations des autorités responsables de la prévention des infections et aux recommandations ou aux directives des organismes de réglementation locaux.

Dri-Tec V Vacuum Heat Drying

SciCan | Your Infection Control Specialist™

www.scican.com

Les logos de Bravo, de Dri-Tec© et de Your Infection Control Specialist sont des marques déposées de SciCan Ltée.

SD-346, Bravo QRG-FR